

Março de 2024

Instruções de uso do NeuMoDx™ LDT Master Mix, RNA



Versão 1

IVD

Para uso em diagnóstico in vitro com os NeuMoDx 288 e
NeuMoDx 96 Molecular Systems

R only

Sujeito a prescrição médica

CE

REF

310100



NeuMoDx Molecular, Inc.
1250 Eisenhower Place
Ann Arbor, MI
48108 EUA

EC **REP**

Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Países Baixos

40600594PTBR_C

Para obter atualizações de folhetos informativos, visite:

www.qiagen.com/neumodx-ifu



Para obter instruções detalhadas, consulte o *Manual do operador do NeuMoDx 288 Molecular System*; N° de ref. 40600108 [REF 500100]

Para obter instruções detalhadas, consulte o *Manual do operador do NeuMoDx 96 Molecular System*; N° de ref. 40600317 [REF 500200] ou N° de ref. 40600655 [REF 500201]

Conteúdo

Uso previsto	5
Resumo e explicação	5
Princípios do procedimento.....	6
Materiais fornecidos	8
Conteúdo do kit	8
Materiais necessários, mas não fornecidos	9
Reagentes.....	9
Equipamento.....	9
Avisos e precauções	10
Informações de segurança.....	10
Precauções	11
Informações de emergência.....	12
Descarte.....	12
Armazenamento, manuseio e estabilidade do produto.....	13
Coleta, transporte e armazenamento de espécimes	13
Instruções de uso	14
Preparo de amostras.....	14
Definição do teste	14
Operação do NeuMoDx System	14
Resultados	17
Resultados inválidos.....	18
Limitações	19

Controle de qualidade	20
Características de desempenho	21
Método	21
Referências	22
Símbolos	23
Informações de contato	25
Informações sobre pedidos	26
Histórico de revisões do documento	28

Uso previsto

A NeuMoDx LDT Master Mix, RNA é uma tira de 16 poços que contém uma mistura principal de RT-PCR em tempo real patenteada e estável à temperatura ambiente que, quando usada em conjunto com primers e sonda(s) específicos do ensaio, permite que o laboratório desenvolva e implemente rapidamente testes desenvolvidos em laboratório (Laboratory Developed Tests, LDT) no NeuMoDx 288 Molecular System e no NeuMoDx 96 Molecular System (NeuMoDx System(s)). Com exceção dos primers e da(s) sonda(s) específicos para LDT, a NeuMoDx LDT Master Mix, RNA incorpora todos os reagentes necessários para a RT-PCR em tempo real. Uma vez validado pelo laboratório do usuário como parte do LDT, este reagente pode ser usado como um componente principal para uma rápida automatização do LDT.

Resumo e explicação

Os testes desenvolvidos em laboratório que incorporam a NeuMoDx LDT RNA Master Mix Test Strip e são implementados no NeuMoDx System oferecem aos laboratórios clínicos uma forma simples, eficiente e direta de integrar rapidamente os LDTs em operações desde a amostra até o resultado. O NeuMoDx System incorpora extração, purificação, amplificação e interpretação de resultados. O sistema permite combinar o seu processo de isolamento de ácido nucleico universal com o uso da NeuMoDx LDT Master Mix, RNA e reagentes para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) em tempo real de uso geral para fornecer resultados altamente precisos para LDTs de amostras clínicas não processadas. Basta que o usuário forneça primers e sonda(s) específicos do ensaio em uma NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip [REF 100400] separada e defina o perfil térmico desejado de RT-PCR em tempo real. Uma vez que os espécimes clínicos e os reagentes específicos do ensaio forem carregados corretamente no NeuMoDx System, o sistema inicia automaticamente o processamento das amostras.

Princípios do procedimento

Os NeuMoDx Systems usam uma combinação de calor, enzimas líticas e reagentes de extração para efetuar a lise celular, a extração de RNA e a inativação/remoção de inibidores de espécimes clínicos não processados antes de apresentar o RNA extraído para detecção por RT-PCR em tempo real. Após a lise, os ácidos nucleicos liberados são capturados por partículas paramagnéticas. Em seguida, as partículas com os ácidos nucleicos ligados são carregadas no NeuMoDx Cartridge, onde os componentes não ligados/não especificamente ligados são retirados por lavagem usando o NeuMoDx Wash Reagent e o RNA ligado é eluído usando o NeuMoDx Release Reagent. O NeuMoDx System mistura o RNA liberado com os primers e sonda(s) para LDT fornecidos pelo usuário e, em seguida, usa uma alíquota dessa solução para reidratar os reagentes de RT-PCR secos na NeuMoDx LDT Master Mix, RNA, que contém todos os reagentes necessários para realizar a RT-PCR em tempo real: transcriptase reversa, Taq DNA polimerase, dNTPs, MgCl₂ e outros agentes tamponantes e excipientes otimizados. Esses reagentes de ensaio secos também contêm os componentes necessários para amplificar uma seção da sequência do controle de processo de amostras (Sample Process Control, SPC2), permitindo a amplificação e detecção simultâneas das sequências de RNA do alvo e do controle. Os reagentes de RT-PCR secos contidos na NeuMoDx LDT Master Mix, RNA não incluem primers ou sondas específicos para LDT (reagentes específicos do ensaio), com exceção dos primers e sonda de SPC2; os reagentes específicos do ensaio devem ser adicionados à NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip pelo usuário. Após a mistura com primers e sonda(s) fornecidos pelo usuário e a reconstituição dos reagentes de RT-PCR secos, o NeuMoDx System dispensa a mistura preparada e pronta para RT-PCR no NeuMoDx Cartridge. A amplificação e a detecção das sequências de RNA do controle e do alvo (se presentes) ocorrem na câmara de PCR do cartucho. A câmara e o cartucho foram projetados para conter o amplicon decorrente da RT-PCR, eliminando praticamente o risco de contaminação pós-amplificação.

A transcriptase reversa usa o primer reverso específico do ensaio fornecido pelo usuário para efetuar a transcriptase reversa do RNA em cDNA. Em seguida, a PCR em tempo real tradicional ocorre na mesma câmara. Os alvos amplificados são detectados em tempo real por meio da química de sondas de hidrólise (comumente chamada de química TaqMan®) usando moléculas de sonda fluorogênica de oligonucleotídeos específicas dos amplicons dos respectivos alvos. As sondas TaqMan consistem em um fluoróforo covalentemente ligado à extremidade 5' da sonda de oligonucleotídeos e um supressor na extremidade 3'. Enquanto a sonda estiver intacta, o fluoróforo e o supressor estão próximos, o que faz com que a molécula supressora suprima a fluorescência emitida pelo fluoróforo via transferência de energia por ressonância de Förster (Förster Resonance Energy Transfer, FRET).

As sondas TaqMan foram projetadas para anelarem-se dentro de uma região-alvo amplificada por um conjunto específico de primers. À medida que a Taq polimerase expande o primer e sintetiza a nova cadeia, a atividade exonuclease de 5' a 3' da Taq polimerase degrada a sonda que anelou-se ao modelo. A degradação da sonda libera o fluoróforo e quebra a sua proximidade com o supressor, superando assim o efeito de supressão devido à FRET e permitindo a fluorescência do fluoróforo. O sinal de fluorescência resultante detectado no termociclador de PCR quantitativa é diretamente proporcional ao fluoróforo liberado e pode ser correlacionado à quantidade de RNA-alvo presente.

Para a detecção do controle de processo de amostras, a sonda TaqMan é marcada com um corante fluorescente (535/556 nm) na extremidade 5' e um supressor de fluorescência na extremidade 3'. O NeuMoDx System monitora o sinal fluorescente emitido pelas sondas TaqMan no final de cada ciclo de amplificação. Quando a amplificação é concluída, o software do NeuMoDx System apresenta as curvas de amplificação de cada amostra ao usuário final para análise.

Materiais fornecidos

Conteúdo do kit

NeuMoDx LDT Master Mix, RNA REF 310100	Unidades por embalagem	Testes por unidade	Testes por embalagem
NeuMoDx LDT Master Mix, RNA <i>Reagentes de RT-PCR secos contendo sonda e primers TaqMan específicos do controle de processo de amostras 2.</i>	6	16	96

Materiais necessários, mas não fornecidos

REF	Conteúdo
100100	NeuMoDx Cartridge
100200	NeuMoDx Extraction Plate <i>Partículas paramagnéticas, enzimas líticas e controles de processo de amostras secas</i>
várias	NeuMoDx Lysis Buffer(s)
400100	NeuMoDx Wash Reagent
400200	NeuMoDx Release Reagent
100400	NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip
235903	Ponteiras Hamilton CO-RE/CO-RE II (300 µL) com filtros
235905	Ponteiras Hamilton CO-RE/CO-RE II (1000 µL) com filtros

Reagentes

- 10 mM de Tris-HCl em pH 8,0, água livre de RNase/DNase ou TE baixo em EDTA (0,1 mM)
- Primers e sonda(s) para LDT

Equipamento*

- NeuMoDx 288 Molecular System [REF 500100] OU
NeuMoDx 96 Molecular System [REF 500200 ou 500201]

* Antes do uso, certifique-se de que os instrumentos foram verificados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante.

Avisos e precauções

Informações de segurança

Ao trabalhar com produtos químicos, sempre use um jaleco adequado, luvas descartáveis e óculos de proteção. Para obter mais informações, consulte as Fichas de dados de segurança (Safety Data Sheets, SDS) aplicáveis. Elas estão disponíveis online em formato PDF compacto e conveniente em www.qiagen.com/neumodx-ifu, onde é possível encontrar, visualizar e imprimir a SDS de cada kit e componente do kit NeuMoDx.

- Para uso em diagnóstico in vitro exclusivamente com os NeuMoDx Systems.
- Não use os reagentes após a data de validade indicada.
- Não use se a embalagem estiver danificada ou se o saco de alumínio estiver aberto ou danificado na entrega.
- Não reutilize nenhum consumível ou reagente NeuMoDx.
- O volume mínimo de espécime depende do volume de aspirado e do tamanho do tubo. Consulte os Manuais do operador do NeuMoDx System e o suplemento sobre LDTs para obter detalhes. Volumes inferiores ao mínimo especificado poderão resultar em um erro "Quantity Not Sufficient" (Quantidade insuficiente).
- Evite a contaminação microbiana e por ribonuclease (RNase) de todos os reagentes e consumíveis. É recomendado o uso de pipetas de transferência descartáveis estéreis e livres de RNase/DNase. Use uma pipeta nova para cada espécime.
- Para dispensar reagentes para LDT, é recomendado o uso de ponteiras de pipeta descartáveis estéreis com filtro e livres de RNase/DNase. Use uma ponteira nova para cada conjunto de primers e sonda(s).
- Para evitar contaminação, não manuseie nem desmonte um NeuMoDx Cartridge pós-amplificação. Sob nenhuma circunstância recolha os NeuMoDx Cartridges do recipiente de resíduos de risco biológico (NeuMoDx 288 Molecular System) ou da lixeira de resíduos de risco biológico (NeuMoDx 96 Molecular System). O NeuMoDx Cartridge foi projetado para evitar contaminação.

- Caso o laboratório também realize testes de PCR em tubo aberto, é necessário ter cuidado para garantir que a NeuMoDx LDT Master Mix, RNA, os outros consumíveis e reagentes necessários para os testes, o equipamento de proteção individual, como luvas e jalecos, e o NeuMoDx System não sejam contaminados.
- É necessário usar luvas nitrílicas sem talco e limpas ao manusear reagentes e consumíveis NeuMoDx. É necessário ter cuidado para não tocar na superfície superior do NeuMoDx Cartridge, na superfície da película de alumínio da NeuMoDx LDT Master Mix, RNA ou da NeuMoDx Extraction Plate, ou na superfície superior do NeuMoDx Lysis Buffer; os produtos devem ser manuseados tocando somente nas superfícies laterais.
- Use sempre luvas nitrílicas sem talco e limpas ao manusear espécimes ou quaisquer reagentes ou consumíveis NeuMoDx.
- Lave muito bem as mãos após realizar o teste.
- Não pipete com a boca. Não fume, beba ou coma em áreas onde os espécimes ou reagentes do kit são manuseados.
- Sempre manuseie os espécimes como se fossem infecciosos e de acordo com procedimentos laboratoriais de segurança como os descritos na publicação *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* (1) e no *Documento M29-A4 do CLSI* (2).
- Descarte os reagentes não usados e resíduos de acordo com os regulamentos nacionais, federais, regionais, estaduais e locais.

Precauções

<p style="text-align: center;">PERIGO</p> 	<p>Contém: ácido bórico.</p> <p>Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.</p> <p>Obtenha instruções especiais antes de usar. Não manuseie antes de ler e compreender todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. Armazene trancado. Descarte o conteúdo/recipiente em um local de descarte de resíduos aprovado.</p>
---	--

Informações de emergência

CHEMTREC

Fora dos EUA e Canadá +1 703-527-3887

Descarte

O produto contém nonilfenol etoxilado, uma substância de desregulação endócrina que pode causar efeitos adversos no ambiente.

Descarte como resíduo perigoso de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Isso também se aplica a produtos não usados.

Não descarte os resíduos líquidos no esgoto.

Siga as recomendações da Ficha de dados de segurança (FDS).

Armazenamento, manuseio e estabilidade do produto

- A NeuMoDx LDT Master Mix, RNA permanece estável em sua embalagem primária a 15–28 °C até a data de validade indicada na etiqueta direta do produto.
- Não use reagentes após a data de validade indicada.
- Não use se o produto ou a embalagem estiver visivelmente danificado.
- Uma vez carregada, a NeuMoDx LDT Master Mix, RNA pode permanecer dentro do NeuMoDx System por 23 dias. A vida útil restante da mistura principal carregada é controlada pelo software e informada ao usuário em tempo real. O sistema solicitará a remoção de uma mistura principal que tenha estado em uso além do período permitido.
- A estabilidade no instrumento dos primers e sonda(s) para LDT dispensados na NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip requer validação do laboratório do usuário.

Coleta, transporte e armazenamento de espécimes

Manuseie todos os espécimes como se fossem capazes de transmitir agentes infecciosos.

A validação das condições ideais de envio de espécimes e da estabilidade dos espécimes deve ser realizada pelo laboratório do usuário em relação à matriz de amostras usada e em relação a cada tipo de teste realizado.

Instruções de uso

Preparo de amostras

1. Coloque uma etiqueta de código de barras de espécime no tubo de espécime desejado. Os testes podem ser executados em uma alíquota em um tubo secundário ou diretamente do tubo de espécime primário, caso seja adequado para o ensaio e compatível com o NeuMoDx System. Para obter detalhes adicionais, consulte os *Manuais do operador do NeuMoDx System e o suplemento sobre LDTs*.
2. Certifique-se de que todas as tampas tenham sido removidas dos tubos de espécime e carregue os tubos de espécime com código de barras no transportador de tubos de espécime apropriado do NeuMoDx System.

Definição do teste

1. Abra o assistente Test Editor (Editor de testes) no software do NeuMoDx System na guia Test (Teste) do menu Tools (Ferramentas).
2. Siga as instruções da tela sensível ao toque para inserir todas as informações específicas do ensaio.

Operação do NeuMoDx System

1. Preencha os transportadores do sistema conforme necessário com os seguintes consumíveis e use a tela sensível ao toque para carregar o(s) transportador(es) no NeuMoDx System:
 - 1a. Ponteiras CO-RE/CO-RE II de 1000 µL
 - 1b. Ponteiras CO-RE/CO-RE II de 300 µL

- 1c. NeuMoDx Cartridge
- 1d. NeuMoDx Extraction Plate
- 1e. NeuMoDx LDT Master Mix, RNA
- 1f. NeuMoDx Lysis Buffer correspondente

Observação: remova a película de alumínio de todos os recipientes antes de carregar

2. Reponha reagente Wash e reagente Release e esvazie o frasco de resíduos de preparação, conforme necessário.
3. Esvazie o recipiente de resíduos de risco biológico conforme necessário, trocando as luvas antes de prosseguir para a próxima etapa.
4. Prepare a mistura de primers/sondas para LDT:
 - 4a. Dilua primers e sonda(s) em água, 10 mM de Tris em pH 8,0 ou TE baixo em EDTA a 1X (0,1 mM de EDTA). A concentração final da mistura de primers/sondas deve ser de 1X após a mistura com 18 µL de eluato na NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip.

Exemplo: Adicione 4 µL de mistura de primers/sondas a 6X em um poço. Uma vez que o eluato for adicionado ao poço e misturado com a mistura de primers/sondas para LDT, haverá 24 µL de mistura de primers/sondas a 1X.
 - 4b. A NeuMoDx recomenda adicionar entre 3 µL e 10 µL da mistura de primers/sondas preparada em cada poço da NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip.
5. Usando uma ponteira de pipeta limpa, perfure o alumínio na NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip de acordo com o número de poços necessários para a quantidade de testes a serem executados.
6. Dispense cuidadosamente a mistura de primers/sondas para LDT na parte inferior dos poços a serem usados na NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip. Não é necessário encher todos os poços, porém deve-se carregar começando pelo poço inferior esquerdo (veja a figura abaixo). Coloque a NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip em um transportador de tiras de teste. Alternativamente, encaixe a tira no transportador e, em seguida, carregue a mistura de primers/sondas para LDT.

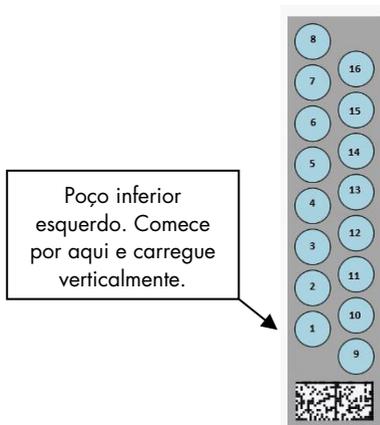


Figura 1. Pedido para preenchimento de poços de mistura para LDT primer/sonda

7. Toque na seta abaixo do transportador de tiras de teste desejado na tela sensível ao toque para carregar a NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip no sistema. Os poços serão exibidos em amarelo. Toque nos poços para definir o tipo de ensaio e mapear os locais na NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip que contêm a mistura de primers/sondas para LDT.
8. Insira o(s) tubo(s) de espécime no transportador de tubos de espécime adequado e certifique-se de remover as tampas de todos os tubos de espécime.
9. Coloque o transportador de tubos de espécime na prateleira de autocarregamento e use a tela sensível ao toque para carregar o transportador no NeuMoDx System. Isto iniciará o processamento do(s) teste(s).

Resultados

Os resultados disponíveis podem ser visualizados ou impressos na guia "Results" (Resultados) da janela "Results" (Resultados) na tela sensível ao toque do NeuMoDx System.

Os resultados dos testes são gerados automaticamente pelo software do NeuMoDx System.

Para ensaios quantitativos, a concentração alvo (\log_{10} UI/mL) será relatada após a implementação de uma calibração válida e a definição de um intervalo dinâmico para o LDT no NeuMoDx System por parte do laboratório.

Para ensaios qualitativos, o resultado de um teste pode ser relatado como Negative (Negativo), Positive (Positivo), Indeterminate (Indeterminado) ou Unresolved (Não resolvido) com base no estado de amplificação do alvo e do controle de processo de amostras. O estado de amplificação é determinado com base nos parâmetros de limite da análise da curva de RT-PCR em tempo real definida no ADF do LDT. Os resultados são relatados com base no algoritmo de decisão indicado na Tabela 1.

Tabela 1. Algoritmo de decisão do teste NeuMoDx LDT RNA MM Test Strip

Resultado	Alvo	Controle de processo de amostras (SPC2)	Eventos do sistema
Positive (Positivo)	Amplified (Amplificado)	N/A (Não aplicável)	No relevant errors (Sem erros relevantes)
Negative (Negativo)	Not Amplified (Não amplificado)	Amplified (Amplificado)	No relevant errors (Sem erros relevantes)
Indeterminate (Indeterminado)	Not Amplified (Não amplificado)	Not Amplified (Não amplificado)	Relevant errors (Erros relevantes)
Unresolved (Não resolvido)	Not Amplified (Não amplificado)	Not Amplified (Não amplificado)	No relevant errors (Sem erros relevantes)

Resultados inválidos

Se um teste realizado no NeuMoDx System não for processado corretamente, ele será relatado como Indeterminate (Indeterminado, IND) ou Unresolved (Não resolvido, UNR) com base no tipo de erro ocorrido.

Um resultado IND (Indeterminado) será relatado se um erro do instrumento/sistema for detectado durante o processamento da amostra. Caso um resultado IND (Indeterminado) seja relatado, será necessário realizar um novo teste a fim de obter um resultado válido.

Um resultado UNR (Não resolvido) será relatado se nenhum alvo for detectado e não houver amplificação do controle de processo de amostras, o que indica uma possível falha de reagentes ou a presença de inibidores. Caso um resultado UNR (Não resolvido) seja relatado, será necessário realizar um novo teste a fim de obter um resultado válido.

Limitações

- A NeuMoDx LDT Master Mix, RNA somente pode ser usada no NeuMoDx System e não é compatível com nenhum outro sistema de diagnóstico molecular automatizado. No entanto, estas tiras de teste podem ser usadas em um processo manual de qualquer plataforma de RT-PCR em tempo real.
- O desempenho da NeuMoDx LDT Master Mix, RNA foi validado usando somente um ensaio de RNA viral modelo da NeuMoDx. As características de desempenho de LDTs usando este reagente são desconhecidas e devem ser validadas pelo laboratório do usuário antes de quaisquer declarações de diagnóstico.
- Visto que a detecção da maioria dos patógenos depende do número de organismos presentes na amostra, a confiabilidade dos resultados depende da coleta, do manuseio e do armazenamento adequados do espécime.
- Podem ocorrer resultados de teste errôneos devido a problemas de coleta, manuseio ou armazenamento de espécimes, erro técnico ou confusão entre amostras. Além disso, podem ocorrer resultados falso-negativos devido a uma quantidade de organismos no espécime inferior à sensibilidade analítica do teste.
- O controle de processo de amostras (Sample Process Control 2, SPC2) pode ser usado como um indicador de falhas do sistema e inibição e deve ser monitorado em cada teste. Deixar de seguir esta instrução pode originar resultados errôneos.
- A capacidade de usar o SPC2 para monitorar a inibição precisa ser validada para cada LDT pelo laboratório antes de usá-lo como ferramenta de controle ou monitoramento.
- Se o SPC2 não amplificar e o resultado do alvo for Negative (Negativo), um resultado Indeterminate (Indeterminado) ou Unresolved (Não resolvido) será relatado e o teste deverá ser repetido.
- O usuário final deve definir e validar os critérios de limite de cada ensaio desenvolvido a fim de obter resultados válidos.
- O uso está limitado a equipes treinadas no uso do NeuMoDx System.
- É recomendável aplicar boas práticas de laboratório, incluindo a troca de luvas entre o manuseio de espécimes de pacientes para evitar a contaminação de espécimes.

Controle de qualidade

Os regulamentos Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) especificam que o laboratório é responsável por implementar procedimentos de controle que monitorem a exatidão e a precisão de todo o processo analítico, e deve estabelecer a quantidade, o tipo e a frequência dos materiais de controle de testagem usando especificações de desempenho verificadas para um sistema de teste não modificado liberado ou aprovado pela FDA (42 CFR Parte 493.1256).

1. Materiais de controle externos devem ser validados pelo laboratório para cada ensaio a ser realizado. Isso inclui a composição dos controles, o horário/frequência da execução e critérios de decisão quanto à invalidação de um conjunto de resultados devido à (in)validade dos controles. Os controles externos não são fornecidos pela NeuMoDx Molecular, Inc.
2. Os primers e a sonda para a detecção do controle de processo de amostras 2 (Sample Process Control 2, SPC2) estão incluídos na NeuMoDx LDT Master Mix, RNA. O monitoramento da detecção do SPC2 permite que o NeuMoDx System monitore a eficácia dos processos de extração de RNA e amplificação por PCR e qualifique os resultados adequadamente.

Características de desempenho

Método

As características de desempenho da NeuMoDx LDT Master Mix, RNA foram determinadas pela NeuMoDx Molecular, Inc. usando um ensaio de RNA modelo para demonstrar a química de isolamento e detecção de RNA para LDT da NeuMoDx em espécimes de plasma. Foram realizados estudos internos no NeuMoDx 288 Molecular System para determinar a sensibilidade analítica do ensaio quando usado em conjunto com a NeuMoDx LDT Master Mix, RNA, bem como a eficácia do processo de extração, extraíndo diluições em série do alvo viral para caracterizar a linearidade. Testes adicionais foram realizados para demonstrar o desempenho equivalente usando o mesmo ensaio de RNA modelo para avaliar a química de isolamento e detecção de RNA para LDT da NeuMoDx em espécimes de plasma no NeuMoDx 96 Molecular System.

A parte configurável do arquivo de definições de ensaio (Assay Definition File, ADF) determina todas as funções específicas de um teste, incluindo o volume de amostra, o perfil de RT-PCR em tempo real, os critérios de limite, os algoritmos de processamento de resultados e outras funções, conforme descrito na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2. Verificação de desempenho dos parâmetros do arquivo de definições de ensaio para a NeuMoDx LDT RNA MM Test Strip

Parâmetros configuráveis do ADF para LDT			
Sample Volume (Volume de amostra)	Ending Fluorescence Start Cycle (Ciclo de início de fluorescência final)	Peak Maximum Cycle (Ciclo de pico máximo)	
Lysis Duration (Duração da lise)	Ending Fluorescence End Cycle (Ciclo de fim de fluorescência final)	Minimum EP (Ponto final mínimo)	
Ct Calling Algorithm (Algoritmo de determinação de Ct)	Fill Check Reporter (Repórter de verificação de enchimento)		Activation (Ativação)
Result Processing Algorithm (Algoritmo de processamento de resultados)	Fill Check Threshold (Limiar de verificação de enchimento)	Real-time PCR (PCR em tempo real)	Cool Down (Resfriamento)
Starting Fluorescence Start Cycle (Ciclo de início de fluorescência inicial)	Target Reporter (Repórter de alvos)		Cycling (X45) (Ciclagem [X45])
Starting Fluorescence End Cycle (Ciclo de fim de fluorescência inicial)	Peak Maximum Cycle (Ciclo de pico mínimo)		

Referências

1. Centers for Disease Control and Prevention. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 6th edition*. HHS Publication No. (CDC) 300859, Revised June 2020.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition*. CLSI document M29-A4; May 2014.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem aparecer nas instruções de uso ou na embalagem e no rótulo:

Símbolo	Definição do símbolo
	Contém reagentes suficientes para <N> reações
	Data de validade
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
	Código de lote
	Fabricante
	Limite de temperatura
	Sujeito a prescrição médica
	Representante autorizado na Comunidade Europeia

Símbolo	Definição do símbolo
	Não reutilizar
	Marca CE
	Consultar as instruções de uso
	Cuidado
	Aviso
	Perigo para a saúde
	Contém
	Contém material biológico de origem animal
	Contém material biológico de origem humana
	Ácido bórico

Informações de contato

Para obter assistência técnica e mais informações, consulte o nosso Centro de Suporte Técnico em **support.qiagen.com**.

Suporte técnico/Informação de vigilância: **support.qiagen.com**

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo será comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país-membro no qual o usuário e/ou o paciente está estabelecido.

Patente: **www.neumodx.com/patents**

Informações sobre pedidos

Produto	REF
NeuMoDx LDT Master Mix, RNA	310100
Produtos relacionados	
NeuMoDx Lysis Buffer 1	400400
NeuMoDx Lysis Buffer 2	400500
NeuMoDx Lysis Buffer3	400600
NeuMoDx Lysis Buffer 4	400700
NeuMoDx Lysis Buffer 5	400900
NeuMoDx Lysis Buffer 6	401700
NeuMoDx Cartridge	100100
NeuMoDx Extraction Plate	100200
NeuMoDx Wash Reagent	400100
NeuMoDx Release Reagent	400200
NeuMoDx LDT Primer/Probe Strip	100400
Hamilton CO-RE / CO-RE II Tips (300 µL) with Filters	235903
Hamilton CO-RE / CO-RE II Tips (1000 µL) with Filters	235905

Para obter informações de licenciamento atualizadas e isenções de responsabilidade específicas do produto, consulte o manual do operador ou o manual do respectivo kit NeuMoDx. Os manuais dos kits NeuMoDx estão disponíveis em www.qiagen.com/neumodx-ifu ou podem ser solicitados em support.qiagen.com ou ao seu distribuidor local.

Observações.

Histórico de revisões do documento

Revisão	Resumo de alterações
A, 05/2022	Primeira edição Novo número de produto (nº de ref. 40600594) criado para submissão de IVDR de reagentes gerais
B, 07/2023	Atualização do endereço da Emergo para Westervoortsewijk 60; 6827 AT Arnhem Países Baixos. Alteração de www.neumodx.com/client-resources para www.qiagen.com/neumodx-ifu .
C, 03/2024	Atualização do conteúdo de instruções detalhadas para adicionar [REF 500100] ao Manual do operador do NeuMoDx 288 Molecular System e [REF 500200] ou N° de ref. 40600655 [REF 500201] ao Manual do operador do NeuMoDx 96 Molecular System. Adição do URL da patente às Informações de contato. Atualização de support@qiagen.com para support.qiagen.com

Contrato de Licença Limitada para NeuMoDx LDT Master Mix, RNA

O uso deste produto implica a aceitação, por parte de qualquer comprador ou usuário do produto, dos seguintes termos:

1. O produto deverá ser usado unicamente em conformidade com os protocolos fornecidos com o produto e com o presente manual e recorrendo ao uso exclusivo de componentes contidos no painel. Nos termos dos direitos de propriedade intelectual, a NeuMoDx não concede nenhuma licença para usar ou incorporar os componentes deste painel com quaisquer componentes não incluídos nele, salvo conforme descrito nos protocolos fornecidos com o produto, no presente manual e em quaisquer protocolos adicionais disponíveis em www.qiagen.com/neumodx-ifu. Alguns desses protocolos adicionais foram fornecidos pelos usuários da NeuMoDx para os usuários da NeuMoDx. Esses protocolos não foram testados por completo nem otimizados pela NeuMoDx. A NeuMoDx não garante nem fornece garantias de que eles não infringam os direitos de terceiros.
2. Com exceção de licenças expressamente declaradas, a NeuMoDx não fornece qualquer garantia de que este painel e/ou o seu uso não infringam os direitos de terceiros.
3. Este painel e os seus componentes estão licenciados para uso único e não podem ser reutilizados, reconstruídos ou revendidos.
4. A NeuMoDx renuncia especificamente a quaisquer outras licenças, expressas ou implícitas, à exceção das expressamente indicadas.
5. O comprador e o usuário do painel concordam em não realizar nem permitir que outra pessoa realize qualquer etapa que possa levar a ou facilitar qualquer um dos atos proibidos acima. A NeuMoDx poderá fazer cumprir as proibições deste Contrato de Licença Limitada em qualquer Tribunal e recuperará todos os seus custos investigativos e judiciais, incluindo honorários advocatícios, em qualquer ação destinada a fazer cumprir este Contrato de Licença Limitada ou qualquer um de seus direitos de propriedade intelectual relativos ao painel e/ou seus componentes.

Para obter os termos de licença atualizados, consulte www.qiagen.com/neumodx-ifu.

03/2024 40600594PTBR_C © 2024 NeuMoDx. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, NeuMoDx™ (QIAGEN Group); TaqMan® (Roche Molecular Systems, Inc.). Os nomes registrados, marcas registradas etc. utilizados neste documento, mesmo quando não marcados especificamente como tal, devem ser considerados protegidos pela lei.

