

Mode d'emploi (Manuel) du QIAsymphony[®] DSP DNA Kit



192 (n° de réf. 937236)



96 (n° de réf. 937255)

Version 2

IVD

Utilisation prévue pour le diagnostic in vitro

À utiliser avec le QIAsymphony DSP DNA Mini Kit et le
QIAsymphony DSP DNA Midi Kit.



REF

937236, 937255



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALLEMAGNE

R1 **MAT**

1127540FRCA

Sommaire

Utilisation prévue	4
Utilisateur prévu	4
Description et principe	5
Résumé et explications	5
Principes de la procédure.....	6
Matériel fourni.....	8
Contenu de la trousse	8
Composants de la trousse.....	9
Matériel nécessaire, mais non fourni	10
Réactifs supplémentaires.....	10
Consommables	10
Équipement.....	11
Protocole et matériel de laboratoire	11
Avertissements et précautions	12
Informations sur la sécurité	12
Précautions	13
Élimination	15
Conservation et manipulation des réactifs	16
Stabilité à l'utilisation.....	16
Collecte, stockage et manipulation des échantillons	18
Procédure	19
Purification automatisée sur QIAAsymphony SP.....	19

Protocole : Purification de l'ADN.....	25
Limitations.....	30
Caractéristiques de performances.....	31
Guide de dépannage.....	32
Symboles.....	35
Coordonnées.....	37
Annexe : Quantification et détermination de la pureté de l'ADN.....	38
Informations pour commander.....	40
Historique des révisions du document.....	42

Utilisation prévue

Les QIAasymphony DSP DNA Mini Kit et QIAasymphony DSP DNA Midi Kit reposent sur une technologie d'extraction et de purification automatisées de l'ADN à partir de spécimens biologiques à l'aide de particules magnétiques.

Le système QIAasymphony DSP DNA est destiné à être utilisé dans le cadre de diagnostics in vitro.

Utilisateur prévu

Ces produits sont destinés à l'usage des professionnels, tels que les techniciens et les médecins formés aux techniques de la biologie moléculaire.

Description et principe

Résumé et explications

Les QIASymphony DSP DNA Kits sont prévus exclusivement pour une utilisation sur l'appareil QIASymphony SP. Les QIASymphony DSP DNA Kits se composent de réactifs pour purification entièrement automatisée d'ADN total provenant de sang total, de couche leuco-plaquettaire, de tissus et d'échantillons de tissu fixés au formol et inclus en paraffine (formalin-fixed, paraffin-embedded, FFPE) humains, ainsi que de purification simultanée d'ADN viral provenant de sang total humain. Toutefois, les caractéristiques de performance n'ont pas été établies pour tous les types de virus, de tissus et de tissus FFPE, et doivent être validées par l'utilisateur. La technologie des particules magnétiques permet la purification d'acides nucléiques de haute qualité qui ne contiennent pas de protéines, de nucléases ni d'autres impuretés. Les acides nucléiques purifiés sont prêts à l'emploi dans les applications en aval, telles que l'amplification ou d'autres réactions enzymatiques. Le poste de travail QIASymphony SP exécute toutes les étapes de la procédure de purification. Il est possible de traiter jusqu'à 96 échantillons, par lot de 24, en un seul cycle. Les protocoles pour tissus et tissus FFPE nécessitent un traitement manuel préalable.

Principes de la procédure

La technologie QIAsymphony combine la rapidité et l'efficacité de la purification de l'acide nucléique à base de silice avec la manipulation pratique des particules magnétiques (Figure 1, ci-dessous). La procédure de purification est conçue pour garantir le traitement sans risques et reproductible d'échantillons potentiellement infectieux. Elle comprend 4 étapes : lyse, liaison, lavage et élution (voir l'organigramme, page 7). L'utilisateur a le choix entre plusieurs volumes d'élution.


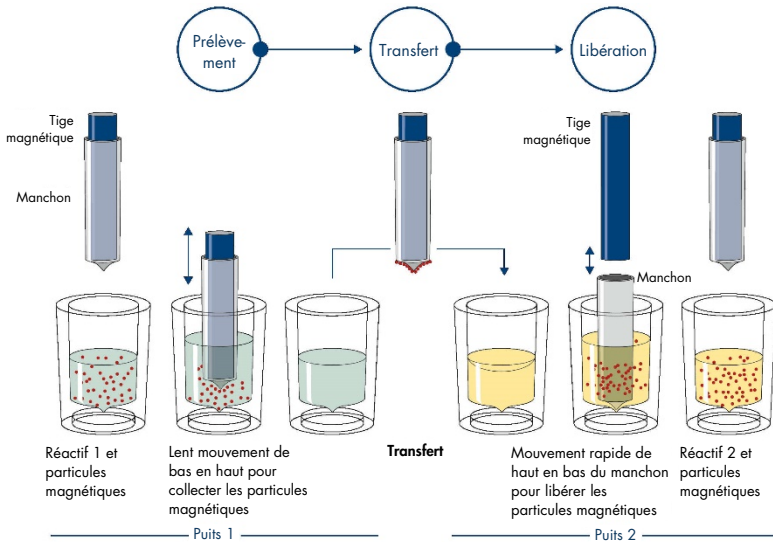


Figure 1. Schéma du principe de fonctionnement du QIAsymphony SP. Le QIAsymphony SP traite un échantillon contenant des particules magnétiques de la manière suivante : Une tige magnétique protégée par un manchon est plongée dans un puits contenant l'échantillon et attire les particules magnétiques. Le manchon de la tige magnétique est placé au-dessus d'un autre puits et les particules magnétiques sont libérées. Ces étapes sont répétées à plusieurs reprises pendant le traitement de l'échantillon. Le QIAsymphony SP utilise une tête magnétique contenant un ensemble de 24 tiges magnétiques, il peut donc permettre de traiter jusqu'à 24 échantillons simultanément.




Procédure QIASymphony DSP DNA

Sang et couche leuco-plaquettaire Tissus

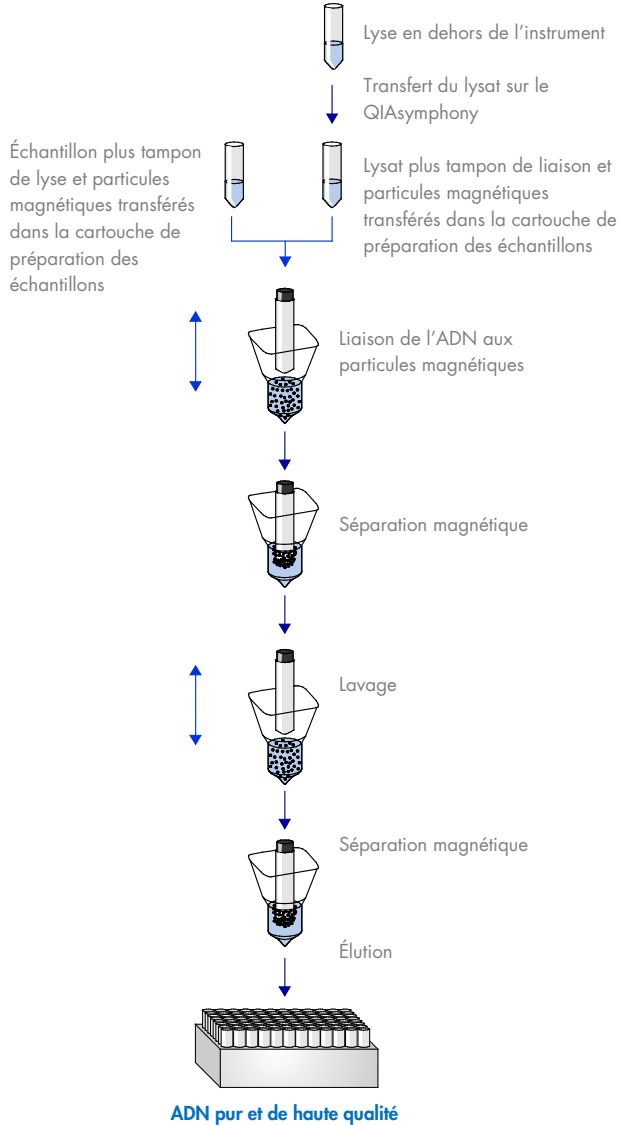

Matériel fourni

Contenu de la trousse

QIASymphony DSP DNA Kit			Mini	Midi
N° de référence			937236	937255
Nombre de réactions			192	96*
Abréviations	Identité		Quantité	
RC	Reagent Cartridge (cartouche de réactif) [†]		2	2
ER	Enzyme Rack (portoir de tubes d'enzyme)		2	2
PL	Piercing Lid (couvercle perforable)		2	2
ATE	Buffer ATE (Tampon ATE) [‡]		20 ml	20 ml
RSS	Reuse Seal Set (jeu de bandelettes d'étanchéité) [§]		2	2
	Mode d'emploi (Manuel)		1	1

* Pour 96 préparations de 1 000 µl ou 144 préparations de 400 µl.

[†] Contient des sels de guanidine. Non compatible avec les désinfectants contenant de l'eau de Javel. Voir page 12 pour connaître les Informations sur la sécurité.

[‡] Contient de l'azotate de sodium comme conservateur.

[§] Un Reuse Seal Set contient 8 bandelettes de scellage réutilisables.

[¶] Voir page 35 pour la liste des symboles avec les définitions.

Composants de la trousse

Les principaux composants de la trousse contenant des principes actifs sont expliqués ci-dessous.

Réactif	Composants	Concentration (p/p) [%]
RC (cartouche de réactif)	Acide maléique	$\geq 0,1$ à < 1
	Chlorhydrate de guanidine	≥ 30 à < 50
	Détergent non ionique	≥ 1 à < 25
	Éthanol	≥ 10 à < 90
	Isopropanol	≥ 30 à < 50
	Chlorure de lithium	≥ 1 à < 10
	Thiocyanate de guanidinium	≥ 20 à < 30
ER (Portoir de tubes d'enzyme)	Protéinase K	≥ 1 à < 10

Matériel nécessaire, mais non fourni

Lors de la manipulation de produits chimiques, porter systématiquement une blouse de laboratoire, des gants jetables et des lunettes de protection adéquats. Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches de données de sécurité (FDS) disponibles auprès du fournisseur du produit.

Réactifs supplémentaires

- Phosphate-buffered saline (PBS, peut être nécessaire pour diluer les échantillons)
- Facultatif : RNase A sans DNase (pour réduire la teneur en ARN)
- Buffer ATL (4 x 50 ml, n° de réf. 939016) pour utilisation avec les protocoles QIASymphony Tissue
- Deparaffinization Solution (1 x 50 ml, n° de réf. 939018) pour utilisation avec les protocoles QIASymphony FFPE Tissue

Consommables

- Cartouches Sample Prep Cartridges, 8-well (n° de réf. 997002)
- 8-Rod Covers (n° de réf. 997004)
- Filter-Tips, 200 µl and 1500 µl (n° de réf. 990332 et 997024)
- Tubes d'échantillon. Pour connaître les formats de tubes primaires et secondaires compatibles, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible dans l'onglet Resource (Ressources), sur la page du produit, à l'adresse www.qiagen.com.
- Tubes de témoin interne à utiliser avec le protocole QIASymphony Virus Blood : Pour connaître les formats de tube compatibles, voir la liste du matériel de laboratoire disponible dans l'onglet Resource (Ressource) sur la page du produit à l'adresse www.qiagen.com.
- Tubes ou plaques d'élution. Pour connaître les formats de tubes et de plaques d'élution compatibles, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible dans l'onglet Resource (Ressources), sur la page du produit, à l'adresse www.qiagen.com.

Équipement*

- QIASymphony SP (n° 9001297)
- Agitateur vortex
- ThermoMixer® ou agitateur incubateur (si nécessaire)
- Centrifugeuse (si nécessaire)

Protocole et matériel de laboratoire

Tableau 1. Synthèse du protocole

Échantillon	Volume d'échantillon (µl)	Volume d'éluion (µl)	Trousse	Protocole QIASymphony SP
Sang total	200	50, 100, 200	Mini	Blood 200 DSP
	400	100, 200, 400	Midi	Blood 400 DSP
	1000	200, 400, 500	Midi	Blood 1000 DSP
Couche leucocytoplaquettaire	200	200, 300, 400	Mini	DNA Buffy Coat 200 DSP
	400	200, 400	Midi	DNA Buffy Coat 400 DSP
Virus blood	200	60, 85, 110 et 165	Mini	VirusBlood200 DSP
Tissu	200	50, 100, 200, 400	Mini	Tissue LC 200 DSP
	200	100, 200, 400	Mini	Tissue HC 200 DSP

Outre le manuel, les fiches de protocole et la liste du matériel de laboratoire se trouvent sous l'onglet « Ressource » (Ressources) de la page du produit sur www.qiagen.com.

* Avant utilisation, s'assurer que les instruments ont été vérifiés et calibrés conformément aux recommandations du fabricant.

Avertissements et précautions

Noter qu'il peut être nécessaire de consulter la réglementation locale avant de signaler tout incident grave survenant en lien avec le produit au fabricant et/ou son représentant autorisé et à l'organisme de régulation du pays de l'utilisateur et/ou du patient.

Utilisation prévue pour le diagnostic in vitro.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser la trousse.

Il convient d'être conscient des risques restants suivants :

Lors de l'utilisation de tubes secondaires, s'assurer que les ID des échantillons ne sont pas mélangés pendant le transfert de l'ID de l'échantillon de la sonde primaire à la sonde secondaire.

Les ID des échantillons peuvent également être saisis manuellement (pour plus de détails, se reporter au *manuel d'utilisation du QIASymphony SP*). Si des données d'ID erronées sont saisies manuellement, une mauvaise corrélation entre l'échantillon et le patient peut se produire.

Informations sur la sécurité

Lors de la manipulation de produits chimiques, porter systématiquement une blouse de laboratoire, des gants jetables et des lunettes de protection adéquats. Pour plus d'informations, consulter les fiches de données de sécurité (FDS) appropriées. Celles-ci sont disponibles en ligne dans un format PDF pratique et compact sur le site www.qiagen.com/safety répertoriant les FDS imprimables pour chaque trousse QIAGEN® et chaque composant.


- Tous les produits chimiques et biologiques sont potentiellement dangereux. Les prélèvements et échantillons sont potentiellement infectieux et doivent être traités comme du matériel présentant un risque biologique.

Informations d'urgence

CHEMTREC

États-Unis et Canada 1-800-424-9300

En dehors des États-Unis et du Canada +1 703-527-3887

<p>MISE EN GARDE</p> 	<p>NE PAS ajouter d'eau de Javel ou de solutions acides directement aux déchets de préparation des échantillons.</p>
---	--

Certains tampons des cartouches de réactif (RC) contiennent des sels de guanidine qui peuvent former des composés hautement réactifs lorsqu'ils sont associés à un javellisant. En cas de déversement de ces tampons, nettoyer avec un détergent de laboratoire approprié et de l'eau. Si le liquide renversé contient des agents potentiellement infectieux, nettoyer l'endroit contaminé d'abord avec un détergent de laboratoire et de l'eau, puis avec de l'hypochlorite de sodium à 1 % (v/v).

Précautions

Les mentions de danger et les conseils de prudence applicables aux composants des QIAsymphony DSP DNA Kits.

QSB1



Contient : thiocyanate de guanidine et isopropanol. Danger! Peut être nocif en cas d'ingestion ou de contact avec la peau. Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une usine de traitement des déchets agréée.

MBS

Avertissement! Provoque une légère irritation cutanée. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Protéinase K



Contient de la protéinase K. Danger! Provoque une légère irritation cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/dispersions/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'exposition prouvée ou suspectée : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éliminer le contenu/récipient dans une usine de traitement des déchets agréée.

QSL1



Contient : chlorhydrate de guanidine et acide maléique. Avertissement! Peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

QSW1



Contient : éthanol; chlorhydrate de guanidine; chlorure de lithium. Avertissement! Peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une usine de traitement des déchets agréée.

QSW2



Contient : éthanol. Danger! Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une usine de traitement des déchets agréée.

Élimination

Les déchets contiennent des échantillons et des réactifs. Ceux-ci peuvent contenir des matières toxiques ou infectieuses et doivent être mis au rebut de manière appropriée. Se reporter aux règles de sécurité en vigueur concernant les procédures de mise au rebut.

Pour plus d'informations, consulter les fiches de données de sécurité (FDS) appropriées. Elles sont disponibles en ligne au format PDF sur www.qiagen.com/safety, où vous pouvez les trouver, les afficher et les imprimer pour chaque trousse et composant de trousse QIAGEN.

Conservation et manipulation des réactifs

Prêter attention aux dates de péremption et aux conditions de conservation imprimées sur l'emballage et les étiquettes des composants. Ne pas utiliser de composants périmés ou stockés dans de mauvaises conditions.

Les QIAasymphony DSP DNA Kits doivent être stockés debout, à température ambiante (15–25 °C). Les particules magnétiques contenues dans les cartouches de réactif (RC) restent actives lorsqu'elles sont stockées à cette température. Dans de bonnes conditions de stockage, la trousse est stable jusqu'à la date limite d'utilisation figurant sur la boîte de la trousse.

Les QIAasymphony DSP DNA Kits contiennent une solution de protéinase K prête à l'emploi qui peut être conservée à température ambiante.

Remarque : La date limite d'utilisation de la trousse figure sur l'étiquette de la boîte du QIAasymphony DSP DNA Kit. Le fichier de résultats indique uniquement les dates limites d'utilisation des cartouches de réactif (RC).

Stabilité à l'utilisation

Les cartouches de réactif (RC) entamées peuvent être conservées pendant une durée maximale de 4 semaines, verticalement à température ambiante (15 à 25 °C), ce qui permet une réutilisation économique des réactifs et garantit une plus grande souplesse dans le traitement des échantillons. Sur les cartouches de réactif (RC) entamées, remettre le couvercle du compartiment contenant les particules magnétiques et sceller les cartouches de réactif (RC) avec les bandelettes d'étanchéité fournies dès la fin du cycle pour éviter l'évaporation.

Pour éviter l'évaporation des réactifs, la cartouche ne doit pas être ouverte pendant plus de 15 h (durée des cycles comprise) à une température ambiante maximale de 32 °C.

L'analyse de lots contenant un faible nombre d'échantillons (< 24) augmente le temps d'ouverture de la cartouche de réactif (RC) et les volumes de tampon nécessaires, ce qui risque de diminuer le nombre total de préparations d'échantillons par cartouche.

Éviter l'exposition des cartouches de réactif (RC) à la lumière UV (p.ex. pour la décontamination) en raison du risque associé de vieillissement prématuré des cartouches et des tampons.

Collecte, stockage et manipulation des échantillons

Pour plus d'informations sur la procédure automatisée (notamment des informations sur les tubes d'échantillonnage qui peuvent être utilisées avec des protocoles spécifiques), le prélèvement, le stockage et la manipulation des échantillons, ainsi que sur les prétraitements spécifiques des échantillons, consulter les fiches de protocole pertinentes et la liste du matériel de laboratoire qui se trouvent sous l'onglet ressources de la page du produit sur www.qiagen.com.

Procédure

Purification automatisée sur QIA Symphony SP

Avec le QIA Symphony SP, la préparation automatisée des échantillons est simple et pratique. Les échantillons, les réactifs, les consommables et les éluats sont séparés dans différents tiroirs. Il suffit de charger les échantillons, les réactifs fournis dans des cartouches spéciales et les portoirs de consommables dans les tiroirs correspondants avant un cycle. Lancer le protocole et récupérer l'ADN purifié dans le tiroir à « Eluate » (Éluat) après traitement. Consulter les manuels d'utilisation fournis avec l'appareil pour le mode d'emploi.

Remarque : Les opérations de maintenance optionnelle ne sont pas obligatoires pour faire fonctionner l'instrument mais elles sont vivement recommandées afin de réduire le risque de contamination.

La gamme des protocoles disponibles est continuellement enrichie et il est possible de télécharger gratuitement d'autres protocoles QIAGEN à l'adresse www.qiagen.com.

Chargement des cartouches de réactif (RC) dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables)

Les réactifs pour la purification de l'ADN sont contenus dans une cartouche de réactif innovante (RC) (Figure 2, page 20). Chaque compartiment de la cartouche contient un réactif particulier, tel que des particules magnétiques, un tampon de lyse, un tampon de lavage ou un tampon d'éluat. Il est possible de refermer les cartouches de réactif (RC) entamées à l'aide de bandelettes d'étanchéité (RSS) en vue d'une réutilisation ultérieure, ce qui évite de générer des déchets dus à des restes de réactifs à la fin de la purification.

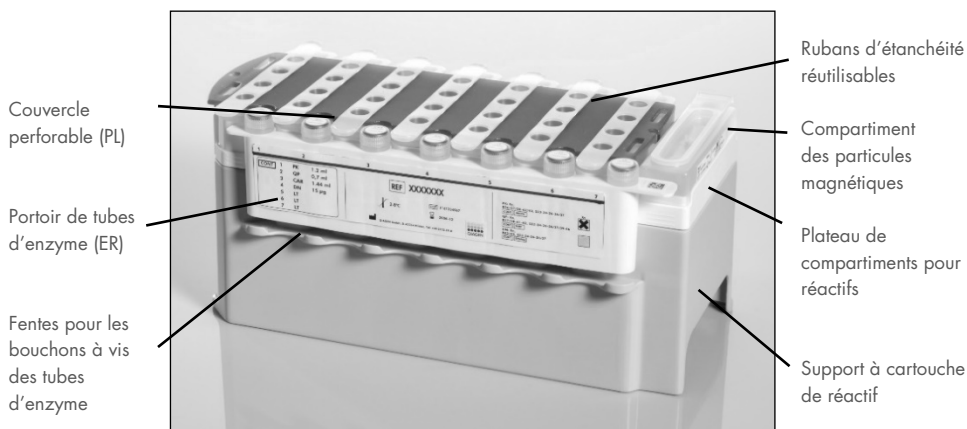


Figure 2. Cartouche de réactif (RC) QIAAsymphony. La cartouche de réactif (RC) contient tous les réactifs nécessaires au cycle.

Avant de commencer la procédure, veiller à ce que les particules magnétiques soient complètement remises en suspension. Avant la première utilisation, retirer le compartiment des particules magnétiques du plateau de la cartouche de réactif, mélanger énergiquement au vortex pendant au moins 3 minutes, puis remettre le compartiment en place. Placer la cartouche de réactif (RC) sur le support pour cartouche de réactif. Placer le portoir de tubes d'enzyme (ER) sur le support de la cartouche de réactif. Avant d'utiliser une cartouche de réactif (RC) pour la première fois, placer le couvercle perforable (PL) sur le dessus de la cartouche de réactif (RC) (Figure 2, ci-dessus).

Remarque : Le couvercle perforable (PL) est coupant. Faire attention lors de sa mise en place sur la cartouche de réactif (RC). Veiller à bien orienter le couvercle perforable (PL) sur la cartouche de réactif (RC).

Après avoir retiré le couvercle de la cuvette à particules magnétiques et ouvert les tubes du portoir à enzymes (les capuchons à vis peuvent être rangés dans les fentes prévues à cet effet, voir la Figure 2, ci-dessus), la cartouche de réactif (RC) est ensuite chargée dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

Les cartouches de réactif (RC) entamées peuvent être stockées jusqu'à la prochaine utilisation (voir « Conservation et manipulation des réactifs », page 16).

Chargement des éléments en plastique dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables)

Les cartouches de préparation des échantillons, les 8-Rod Covers (tous deux préalablement rangés dans des boîtes) et Disposable filter-tips (embouts de 200 µl sur supports bleus et embouts de 1 500 µl sur supports gris) sont chargés dans le tiroir à réactifs et consommables « Reagents and Consumables ».

Remarque : Veiller à retirer les couvercles des boîtes avant leur chargement dans le tiroir à réactifs et consommables « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

Remarque : Les embouts sont munis de filtres pour éviter la contamination croisée.

Les fentes pour supports d'embouts de la table de travail QIASymphony SP peuvent accueillir les deux types de supports. Le QIASymphony SP identifie le type d'embout chargé au moment de l'inventaire.

Remarque : Ne pas remplir les supports d'embouts, les boîtes des cartouches de préparation d'échantillons ou les 8-Rod Covers avant de lancer un nouveau cycle. Le QIASymphony SP peut utiliser des portoirs à embouts ou des boîtes d'unités partiellement usagé(e)s.

Pour connaître les consommables nécessaires, voir la fiche du protocole correspondant disponible en ligne à l'adresse www.qiagen.com. Pour plus d'informations sur la commande de matériel en plastique, voir page 40.

Chargement du tiroir « Waste » (Déchets)

Les cartouches de préparation des échantillons et les 8-Rod Covers utilisés au cours d'un cycle sont rangés dans des boîtes vides situées dans le tiroir « Waste » (Déchets). Veiller à ce que le tiroir « Waste » (Déchets) contienne suffisamment de boîtes vides pour contenir tous les éléments en plastique usagés du cycle.

Remarque : Veiller à retirer les couvercles des boîtes avant leur chargement dans le tiroir « Waste » (Déchets). Si des boîtes 8-Rod Covers sont utilisées dans le but de récupérer à la fois les cartouches de préparation des échantillons et les 8-Rod Covers, veiller à retirer le séparateur de boîtes.

Vous devez placer un sac destiné aux embouts à filtre usagées à l'avant du tiroir « Waste » (Déchets).

Remarque : L'automate ne vérifie pas la présence du sac d'élimination des pointes. Vérifier la bonne fixation du sac d'élimination des pointes avant le démarrage d'un cycle. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de votre appareil. Videz le sac d'embouts au plus tard après le traitement de 96 échantillons maximum afin d'éviter un enrayage dû aux embouts.

Un récipient à déchets recueille les déchets liquides générés pendant la procédure de purification. Le tiroir « Waste » (Déchets) ne peut être fermé que si le flacon à déchets est en place. Éliminer les déchets liquides conformément aux réglementations locales de sécurité et de respect de l'environnement. Ne pas autoclaver le flacon à déchets rempli. Videz le flacon de déchets au plus tard après le traitement de 96 échantillons maximum.

Chargement du tiroir « Eluate » (Éluat)

Chargez le portoir d'éluotion requis dans le tiroir « Eluate » (Éluat). Dans la mesure où le stockage à long terme des éluats dans le tiroir à éluats « Eluate » peut entraîner leur évaporation, la position de refroidissement doit être utilisée. Utilisez uniquement la « Elution slot 1 » (Fente d'éluotion 1) avec le support réfrigérant correspondant.

Vérification d'inventaire

Avant le démarrage d'un cycle, l'appareil vérifie que les consommables chargés dans les différents tiroirs sont en quantité suffisante pour les lots en file d'attente.

Préparation du matériel de prélèvement

Les QIASymphony DSP DNA Kits sont conçus pour la purification automatisée de l'ADN total provenant de sang total, de couche leuco-plaquettaire, de tissus et de tissus FFPE humains, ainsi que d'ADN viral provenant de sang total humain (Tableau 1, page 11).

Évitez la formation de mousse dans ou à la surface des échantillons. Selon le matériel de départ, un prétraitement de l'échantillon peut se révéler nécessaire. Les échantillons doivent revenir à température ambiante (15 à 25 °C) avant le début de l'analyse. Les protocoles pour tissus et tissus FFPE nécessitent un traitement manuel préalable. Pour en savoir plus sur la procédure automatisée, y compris sur les tubes d'échantillons compatibles avec un protocole spécifique et le prétraitement des échantillons, voir la fiche du protocole correspondant et la liste de matériel de laboratoire disponibles en ligne à l'adresse www.qiagen.com.

Rendement de l'ADN purifié

Les rendements en ADN dépendent du type d'échantillon, du nombre de cellules nucléées dans l'échantillon, de la qualité du matériel de départ et du protocole utilisé pour isoler l'ADN. L'éluat dans des volumes plus petits augmente la concentration finale d'ADN dans l'éluat mais réduit légèrement le rendement global en ADN. Il est recommandé d'utiliser un volume d'éluat approprié pour l'application prévue en aval. Les QIASymphony DSP DNA Kits copient l'ARN et l'ADN si les deux sont présents dans l'échantillon. Afin de minimiser le contenu en ARN dans l'échantillon, ajouter de la RNase A à l'échantillon à l'étape indiquée dans le protocole de prétraitement respectif. Pour plus d'informations, consulter les fiches de protocole disponibles sur www.qiagen.com.

Stockage de l'ADN

Les conditions et la durée de stockage de l'acide nucléique purifié dépendent du matériau d'échantillon utilisé. De plus amples informations sont fournies dans les fiches de protocole correspondantes, disponibles sur www.qiagen.com.

Remarque : La stabilité de l'éluat dépend fortement de divers facteurs et est liée à l'application spécifique en aval. Elle a été établie pour les QIASymphony DSP DNA Kits en conjonction avec des applications exemplaires en aval. Il incombe à l'utilisateur de consulter le mode d'emploi de l'application en aval spécifique utilisée dans son laboratoire et/ou de valider l'ensemble de la procédure pour établir des conditions de stockage appropriées.

Protocole : Purification de l'ADN

Cette section décrit un protocole général d'utilisation des QIASymphony DSP DNA Kits. Les fiches de chaque protocole, disponibles en ligne à l'adresse www.qiagen.com, donnent des informations détaillées, notamment les volumes et les tubes à utiliser.

Remarques importantes avant de commencer

- Assurez-vous de maîtriser l'utilisation du QIASymphony SP. Consulter les manuels d'utilisation fournis avec l'appareil pour le mode d'emploi.
- Les opérations de maintenance optionnelle ne sont pas obligatoires pour faire fonctionner l'instrument mais elles sont vivement recommandées afin de réduire le risque de contamination.
- Avant de commencer la procédure, lire la rubrique « Principes de la procédure », à partir de la page 6.
- Assurez-vous de prendre connaissance de la fiche du protocole correspondant à la procédure à réaliser (disponible en ligne à l'adresse www.qiagen.com).
- Avant d'utiliser une cartouche de réactif pour la première fois, vérifiez que les Buffer QSL1 et QSB1 ne contiennent aucun précipité. Si nécessaire, retirez les cuves contenant les Buffer QSL1 et QSB1 de la cartouche de réactif et incubez-les pendant 30 minutes à 37 °C en agitant de temps en temps pour dissoudre les précipités. Veillez à remettre les compartiments à la bonne position. Si la cartouche de réactif est déjà percée, s'assurer que les cuves sont scellées à l'aide des bandelettes de scellage réutilisables et incubez la cartouche de réactif complète pendant 30 minutes à 37 °C dans un bain-marie en agitant de temps en temps.
- Évitez d'agiter vigoureusement la cartouche de réactif (Reagent Cartridge, RC) afin de ne pas former de mousse, source potentielle de problèmes de détection du niveau de liquide.

Étapes préliminaires

- Avant de démarrer la procédure, veillez à ce que les particules magnétiques soient toutes remises en suspension. Agitez au mélangeur vortex vigoureusement le logement contenant les particules magnétiques pendant au moins 3 minutes avant la première utilisation.
- Veillez à mettre le couvercle perforable sur la cartouche de réactif et à retirer le couvercle du logement de particules magnétiques ou, si vous utilisez une cartouche de réactif partiellement usagée, veillez à retirer les rubans d'étanchéité réutilisables.
- Veillez à ouvrir les tubes contenant l'enzyme.
- Si les échantillons portent un code-barres, les orienter dans le porte-tubes de manière à ce que les codes-barres se trouvent face au lecteur, à gauche du QIAsymphony SP.
- Pour connaître la compatibilité des tubes avec un protocole spécifique, voir la liste de matériel de laboratoire correspondante (disponible en ligne à l'adresse www.qiagen.com).
- Pour connaître les volumes minimaux d'échantillon des tubes primaires et secondaires pour un protocole spécifique, voir la liste de matériel de laboratoire correspondante (disponible en ligne à l'adresse www.qiagen.com). Les fiches indiquent également les tubes compatibles avec chaque protocole.

Procédure

1. Fermer tous les tiroirs et le capot.
2. Mettez le QIAsymphony SP sous tension puis attendez que l'écran Sample Preparation (Préparation de l'échantillon) apparaisse et que la procédure d'initialisation soit terminée.

Le bouton d'alimentation se trouve dans l'angle inférieur gauche du QIAsymphony SP.

3. Connectez-vous à l'instrument.

4. Assurez-vous que le tiroir « Waste » (Déchets) est correctement préparé puis procédez à une vérification d'inventaire de ce tiroir, en incluant la goulotte des embouts et les déchets liquides. Remplacez le sac d'élimination des embouts si nécessaire.

5. Chargez le portoir d'éluion requis dans le tiroir « Eluate » (Éluat).

Ne chargez pas de plaque à 96 puits dans la « Elution slot 4 » (Fente d'éluion 4).

Utilisez la « Elution slot 1 » (Fente d'éluion 1) avec le support réfrigérant correspondant.

Lorsque vous utilisez une plaque à 96 puits, veillez à l'orienter correctement car un positionnement incorrect peut provoquer un mélange d'échantillons dans l'analyse à venir.

Lorsque vous utilisez le portoir Elution Microtubes CL, retirez le fond en tournant le portoir jusqu'à ce que le fond se désolidarise.

6. Chargez la ou les cartouche(s) de réactif et les consommables nécessaires dans le tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

7. Procédez à une vérification d'inventaire du tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables).

8. Mettez les échantillons dans le support d'échantillon qui convient puis chargez-les dans le tiroir « Sample » (Échantillon).

Remarque : Pour garantir une détection correcte du niveau de liquide, enfoncer les tubes dans le porte-tube ou l'élément d'insertion, si des éléments d'insertion sont utilisés.

Important : Pour les application VirusBlood200, le ou les tubes contenant le mélange témoin interne–Buffer ATE doivent être placés dans le slot A du tiroir « Sample » (Échantillon).

Pour plus d'informations sur la préparation du mélange et l'utilisation d'un témoin interne, se reporter à la fiche de protocole correspondante (disponible sur

www.qiagen.com).

9. À l'aide de l'écran tactile, saisissez les informations requises pour chaque lot d'échantillons à traiter.

Saisir les informations suivantes :

9a. Informations relatives aux échantillons (selon les portoirs utilisés)

9b. Protocole à effectuer (jeu de témoins de dosage)

9c. Volume d'élution et position de sortie

9d. Pour les applications VirusBlood200 : tube(s) contenant un ou plusieurs témoins internes

Une fois les informations sur le lot saisies, l'état passe de « LOADED » (CHARGÉ) à « QUEUED » (DANS LA FILE D'ATTENTE). Dès qu'un lot est en attente, le bouton Run (Exécuter) apparaît.

10. Appuyez sur le bouton Run (Exécuter) pour lancer la procédure de purification.

Toutes les étapes de traitement sont entièrement automatisées. À la fin de l'analyse de protocole, le statut du lot passe de « RUNNING » (EN COURS) à « COMPLETED » (TERMINÉ).

11. Sortez le portoir d'élution contenant les acides nucléiques purifiés du tiroir « Eluate » (Éluat).

12. L'ADN est prêt à l'emploi ou peut être conservé. Des détails sont fournis dans les fiches de protocole correspondantes, disponibles sur www.qiagen.com.

Nous vous recommandons de sortir la plaque d'éluat du tiroir « Eluate » (Éluat) dès la fin de l'analyse. Selon la température et le degré d'humidité, les plaques d'élution laissées sur le QIASymphony SP après un cycle peuvent subir une condensation ou une évaporation.

En règle générale, les particules magnétiques ne sont pas transférées dans les éluats. En cas de transfert, les particules magnétiques dans les éluats n'affecteront pas la plupart des applications en aval.

Si les particules magnétiques doivent être supprimées avant l'exécution des applications en aval, il convient d'abord de placer les tubes ou les plaques contenant les éluats dans un portoir magnétique approprié et de transférer les éluats dans un tube propre (voir l'annexe page 38).

Des fichiers de résultats sont créés pour chaque plaque d'élution.

13. Si la cartouche de réactif n'est pas vide, la sceller avec les bandelettes d'étanchéité fournies et fermer les tubes de protéinase K avec des bouchons à vis immédiatement après la fin du cycle pour éviter l'évaporation.

Remarque : Pour plus d'informations sur le stockage des cartouches de réactif (Reagent Cartridges, RC) partiellement usagées, voir « Conservation et manipulation des réactifs », page 16.

14. Mettez au rebut les tubes d'échantillon et autres déchets conformément aux règles de sécurité locales.

Voir page 12 pour connaître les Informations sur la sécurité.

15. Nettoyez le QIASymphony SP.

Suivez les consignes de maintenance des manuels d'utilisation fournis avec l'instrument. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les protections des embouts afin de limiter le risque de contamination croisée.

16. Fermez les tiroirs de l'instrument puis mettez le QIASymphony SP hors tension.

Limitations

Les performances du système ont été déterminées lors d'essais d'évaluation des performances en purifiant de l'ADN total provenant de sang total, de couche leuco-plaquettaire, de tissus et de tissus FFPE humains, ainsi que d'ADN viral provenant de sang total humain.

Il incombe à l'utilisateur de valider la performance du système pour toutes les procédures utilisées dans son laboratoire et non couvertes par les études d'évaluation de la performance QIAGEN.

Afin de limiter les risques d'impact négatif sur les résultats diagnostiques, des témoins appropriés doivent être utilisés pour les applications en aval. Pour une validation ultérieure, il est conseillé de suivre les directives de la Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques (ICH) exposées dans *ICH Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures : Text And Methodology*.

Tous les résultats diagnostiques générés doivent être interprétés en tenant compte des autres observations cliniques ou résultats biologiques disponibles.

Caractéristiques de performances

Les caractéristiques de performance applicables peuvent être trouvées sous l'onglet ressource (ressources) de la page produit sur www.qiagen.com.

Guide de dépannage

Ce guide de dépannage peut vous permettre de résoudre les problèmes éventuels. Pour de plus amples informations, consulter également la page de la foire aux questions dans notre centre d'assistance technique à l'adresse suivante : www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Les scientifiques des services techniques QIAGEN seront ravis de répondre à toutes les questions sur les informations et/ou protocoles figurant dans ce manuel ou sur les technologies d'échantillons et de dosage (pour les coordonnées, visiter le site www.qiagen.com).

Commentaires et suggestions

Manipulation générale

Message d'erreur affiché sur l'écran tactile

En cas d'affichage d'un message d'erreur pendant une séquence de protocole, reportez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec l'instrument.

Présence d'un précipité dans le logement des réactifs d'une cartouche ouverte

a) Évaporation du tampon

Une évaporation excessive peut augmenter la concentration en sel dans les tampons. Jeter la cartouche de réactif (RC). Veiller à sceller les compartiments de tampon d'une cartouche de réactif (RC) partiellement utilisée avec des bandelettes d'étanchéité lorsqu'elle n'est pas utilisée pour la purification.

b) Stockage des cartouches de réactif (RC)

Le stockage de la cartouche de réactif (RC) en dessous de 15 °C peut entraîner la formation de précipités. Si nécessaire, retirer les compartiments contenant les Buffer QSL1 et QSB1 de la cartouche de réactif et les incubés dans un bain-marie* à 37 °C pendant 30 min en agitant de temps en temps pour dissoudre le précipité. Veiller à remettre le compartiment dans la bonne position. Si la cartouche de réactif (RC) est déjà perforée, vérifier que le compartiment est refermé par une bandelette d'étanchéité et incubé la cartouche de réactif (RC) entière au bain-marie* à 37 °C pendant 30 min en remuant ponctuellement.

Faible rendement d'ADN

a) Remise en suspension incomplète des particules magnétiques

Avant de commencer la procédure, veiller à ce que les particules magnétiques soient complètement remises en suspension. Avant emploi, mélanger au Vortex pendant au moins 3 min.

* S'assurer que tous les instruments sont vérifiés et calibrés régulièrement selon les instructions du fabricant.

Commentaires et suggestions

- | | | |
|----|--|---|
| b) | Les échantillons de sang ou de couche leuco-plaquettaire congelés n'ont pas été mélangés correctement après décongélation. | Décongeler les échantillons de sang ou de couche leuco-plaquettaire congelés en les agitant légèrement pour assurer un mélange complet. |
| c) | Lyse d'échantillon incomplète | Avant utilisation, vérifier l'absence de précipité dans le Buffer QSL1 et le Buffer QSB1. Si nécessaire, retirer les compartiments contenant les tampons QSL1 et QSB1 de la cartouche de réactif (RC) et les incuber dans un bain-marie* pendant 30 min à 37 °C en agitant de temps en temps pour dissoudre le précipité. Si la cartouche de réactif (RC) est déjà entamée, vérifier que les compartiments sont scellés à l'aide de bandelettes d'étanchéité et incuber l'ensemble de la cartouche au bain-marie à 37 °C pendant 30 min en agitant de temps en temps. * |
| d) | Digestion incomplète des échantillons de tissus | S'assurer que le tissu est complètement digéré en prolongeant le temps d'incubation avec la protéinase K. |
| e) | Obstruction de la pointe de pipette par une substance insoluble | La substance insoluble n'a pas été éliminée de l'échantillon avant la purification sur QIAsymphony. Si nécessaire, suivre la procédure de prétraitement décrite dans la fiche du protocole correspondant, par exemple pour les échantillons visqueux. Les fiches de protocoles sont disponibles en ligne à l'adresse www.qiagen.com . |
| f) | Mauvaise préparation de la couche leuco-plaquettaire lors de l'utilisation du protocole de la couche leuco-plaquettaire. | S'assurer que la fraction leucocytaire est récoltée efficacement. |
| g) | Faible taux de leucocytes dans l'échantillon de sang total utilisé comme matière première pour la préparation de la couche leuco-plaquettaire. | En cas d'utilisation du protocole de couche leuco-plaquettaire, augmenter le volume de sang total utilisé et maintenir constant le volume de leucocytes prélevés. |
| h) | Lyse incomplète des tissus | Si le lysat contient de la matière insoluble, prolonger le temps d'incubation avec la protéinase K. |
| i) | Le culot a été perdu pendant le prétraitement FFPE au xylène/éthanol. | Observer attentivement les échantillons pendant le prétraitement. |

L'ADN ne réagit pas bien dans des applications en aval

- | | | |
|----|---|--|
| a) | Trop peu d'ADN utilisé dans l'application en aval | Quantifier l'ADN purifié par la mesure spectrophotométrique de l'absorbance à 260 nm (voir l'annexe , page 38).* |
|----|---|--|

* S'assurer que tous les instruments sont vérifiés et calibrés régulièrement selon les instructions du fabricant.

Commentaires et suggestions

- b) Trop d'ADN utilisé dans l'application en aval

Un excès d'ADN peut inhiber certaines réactions enzymatiques. Quantifier l'ADN purifié par la mesure spectrophotométrique de l'absorbance à 260 nm (voir l'annexe , page 38). *

Le rapport A_{260}/A_{280} de l'ADN purifié est faible.












La mesure d'absorbance à 320 nm n'a pas été soustraite des mesures d'absorbance à 260 et 280 nm.

Pour corriger la présence de particules magnétiques dans l'éluat, il faut effectuer une lecture de l'absorbance à 320 nm et la soustraire des lectures de l'absorbance obtenues à 260 et 280 nm (voir l'annexe , page 38).*

* S'assurer que tous les instruments sont vérifiés et calibrés régulièrement selon les instructions du fabricant.

Symboles

Les symboles suivants apparaissent dans le mode d'emploi ou sur l'emballage et l'étiquetage :

Symbole	Définition du symbole
 Σ <N>	Contient suffisamment de réactifs pour <N> réactions
	À utiliser avant
	Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne 2017/746 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Numéro de matériel (c.-à-d. étiquette de composant)
	Composants
	Contient
	Nombre
	Code article international (Global Trade Item Number, GTIN)

Symbole	Définition du symbole
Rn	R désigne une révision du mode d'emploi et n représente le numéro de révision
	Limites de température
	Fabricant
	Consulter le mode d'emploi
	Conserver à l'abri des rayons du soleil
	Avertissement/mise en garde
PROTK	Protéinase K
WELL	Numéro du puits (c.-à-d. puits de la cartouche de réactif)
REAG CART	Cartouche de réactif
EtOH	Éthanol
UDI	Identificateur unique d'appareil

Coordonnées

Pour bénéficier d'une assistance technique et obtenir plus d'informations, consulter notre Centre d'assistance technique à l'adresse www.qiagen.com/Support, appeler le 00800-22-44-6000 ou contacter l'un des Services techniques QIAGEN ou l'un de ses distributeurs locaux (voir la quatrième de couverture ou le site www.qiagen.com).

Annexe : Quantification et détermination de la pureté de l'ADN

Les concentrations en ADN doivent être déterminées par mesure de l'absorbance à 260 nm (A_{260}) dans un spectrophotomètre. Les lectures d'absorbance à 260 nm doivent être comprises entre 0,1 et 1,0 pour être précises. Une unité d'absorbance à 260 nm correspond à une concentration de 50 µg d'ADN par millilitre ($A_{260} = 1 = 50 \text{ µg/ml}$).

Utiliser le Buffer ATE pour diluer les échantillons et pour étalonner le spectrophotomètre.

Le rapport entre les valeurs d'absorbance à 260 et 280 nm permet d'estimer la pureté de l'ADN. La pureté est déterminée en calculant le rapport entre l'absorbance corrigée à 260 nm et l'absorbance corrigée à 280 nm, c'est-à-dire, $(A_{260} - A_{320}) / (A_{280} - A_{320})$.

Mesurer l'absorbance à 320, 280 et 260 nm. Soustraire la lecture de l'absorbance obtenue à 320 nm des lectures obtenues à 260 et 280 nm pour corriger la présence éventuelle d'une lecture de fond.

Utiliser la formule suivante pour calculer la concentration et le rendement de l'ADN :

Concentration de l'échantillon d'ADN = $50 \text{ µg/ml} \times (A_{260} - A_{320}) \times \text{facteur de dilution}$

Quantité totale d'ADN purifié = concentration x volume d'échantillon en millilitres

Au cas où des particules magnétiques seraient entraînées dans l'éluat et pourraient affecter l'application en aval (par exemple, l'ADN purifié doit être analysé par séquençage capillaire fluorescent), le tube contenant l'éluat doit d'abord être appliqué à un séparateur magnétique approprié et l'éluat transféré dans un tube propre.

En l'absence de séparateur magnétique approprié, centrifugez le tube contenant l'ADN pendant 1 minute à vitesse maximale dans une microcentrifugeuse afin que les particules magnétiques restantes forment un culot.

Remarque : Pour une quantification précise de l'ADN par absorbance à 260 nm, nous recommandons de diluer l'échantillon dans le tampon d'élution correspondant. La dilution de l'échantillon dans l'eau peut dériver vers des valeurs inexacts. Le tampon d'élution présente une forte absorbance à 220 nm, pouvant induire un bruit de fond élevé des valeurs d'absorbance si le zéro du spectrophotomètre n'est pas convenablement réglé. L'évaporation des éluats augmente potentiellement le risque d'impact sur la mesure, en particulier lorsque de faibles quantités d'éluats sont utilisées non diluées. Un tampon d'élution supplémentaire pour nettoyer le spectrophotomètre est fourni dans une bouteille séparée avec les QIASymphony DSP DNA Kit.

Informations pour commander

Produit	Contenu	N° de réf.
QIASymphony DSP DNA Mini Kit (192)	Pour 192 préparations de 200 µl chacune : 2 cartouches de réactif, portoirs de tubes d'enzyme et accessoires inclus	937236
QIASymphony DSP DNA Midi Kit (96)	Pour 96 préparations de 1 000 µl chacune ou 144 préparations de 400 µl chacune : 2 cartouches de réactif, portoirs de tubes d'enzyme et accessoires inclus	937255
Produits connexes		
Buffer ATL (4 x 50 ml)	4 x 50 ml de tampon de lyse pour la purification des acides nucléiques à l'aide des QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits et QIASymphony DSP DNA Mini Kit	939016
Deparaffinization Solution (1 x 50 ml)	Deparaffinization Solution 1 x 50 ml	939018
Accessory Trough (10)	Compartiments auxiliaires à utiliser sur QIASymphony SP	997012
Reagent Cartridge Holder (2)	Support à cartouche de réactif à utiliser sur le QIASymphony SP	997008
Tube Insert, 2 ml, v2, sample carrier, Qsym	Adaptateur pour tubes secondaires (tubes de 2 ml à bouchon à vis) à utiliser sur le porte- tubes QIASymphony	9242083
Tube Insert, 11 mm, Revision, sample carrier, Qsym	Adaptateur pour tubes principaux (11 mm, avec l'élément d'insertion de tube 2A) à utiliser avec le porte-tubes du QIASymphony SP Software Version (toutes les versions logicielles)	9242057

Produit	Contenu	N° de réf.
Tube Insert, 13 mm, sample carrier, Qsym	Adaptateur pour tubes principaux (13 mm, avec l'élément d'insertion de tube 1A) à utiliser avec le porte-tubes du QIASymphony SP Software Version (toutes les versions logicielles)	9242058
Cooling Adapter, 2 ml, v2, Qsym (24)	Adaptateur de refroidissement pour tubes de 2 ml à bouchon à vis; à utiliser avec les appareils QIASymphony SP/AS (version logicielle 3.1 ou supérieure)	9020674
Cooling Adapter, EMT, v2, Qsym	Adaptateur réfrigérant pour portoirs EMT; pour une utilisation avec les appareils QIASymphony SP/AS (version logicielle 3.1 ou supérieure)	9020730
Sample Prep Cartridges, 8-well (336)	Cartouches de préparation de l'échantillon à 8 puits à utiliser sur le QIASymphony SP	997002
8-Rod Covers (144)	8-Rod Covers pour utilisation avec QIASymphony SP	997004
Filter-Tips, 200 µl (1024)	Pointes à filtre jetables, sur portoir; (8 × 128). Pour une utilisation avec le QIAcube® et les instruments QIASymphony SP/AS	990332
Filter-Tips, 1500 µl (1024)	Pointes de filtres jetables, sur portoir; (8 × 128). Pour utilisation avec les appareils QIASymphony SP/AS	997024
Tip Disposal Bags (15)	Sacs d'élimination des pointes à utiliser sur QIASymphony SP/AS	9013395
Reuse Seal Set (20)	Ensembles d'étanchéité réutilisables pour sceller les cartouches de réactif QIASymphony	997006

Pour obtenir des renseignements actualisés et les clauses de non-responsabilité spécifiques aux produits, consultez le manuel de la trousse ou le manuel d'utilisation QIAGEN correspondant. Les manuels des trousse et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles sur www.qiagen.com ou peuvent être demandés aux services techniques QIAGEN ou au distributeur local.

Historique des révisions du document

Révision	Description
R1, juin 2022	<p>Version 2, révision 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Mise à jour de la version 2 pour la conformité au RDIV- Mise à jour de la section Utilisation prévue et Limitations- Mise à jour de la section Description et Principe- Mise à jour des sections Matériel nécessaire (ajout d'ingrédients actifs) et Matériel nécessaire mais non fourni- Mise à jour des sections Avertissements et précautions (ajout des risques résiduels, des informations sur les urgences et l'élimination)- Mise à jour de la section Stockage et manipulation des réactifs- Mise à jour de la section Collecte, stockage et manipulation des échantillons- Mise à jour de la section Procédure- Mise à jour de la section Caractéristiques de performances- Mise à jour de la section Symboles- Mise à jour des informations relatives à la commande- Mise à jour de l'annexe : Section Quantification et détermination de la pureté de l'ADN

Contrat de licence limité pour les QIAsymphony DSP DNA Mini/Midi Kits

En utilisant ce produit, l'acheteur ou l'utilisateur accepte les conditions suivantes :

1. Le produit doit être utilisé uniquement avec les composants du panel, conformément aux protocoles fournis avec le produit et à ce manuel. QIAGEN n'accorde aucune licence sous sa propriété intellectuelle pour utiliser ou intégrer les composants fournis dans ce panel avec tout autre composant non fourni dans ce panel, à l'exception de ce qui est stipulé dans les protocoles fournis avec le produit, dans ce manuel et dans d'autres protocoles disponibles sur le site www.qiagen.com. Parmi ces protocoles supplémentaires, certains ont été fournis par des utilisateurs QIAGEN pour des utilisateurs QIAGEN. Ces protocoles n'ont pas été rigoureusement testés ou optimisés par QIAGEN. QIAGEN ne saurait être tenu pour responsable de leur utilisation et n'offre aucune garantie que ces protocoles ne portent pas atteinte aux droits de tiers.
2. En dehors des licences énoncées expressément, QIAGEN n'offre aucune garantie indiquant que ce panel et/ou sa ou ses utilisations ne violent pas les droits de tiers.
3. Ce panel et ses composants sont sous licence pour une utilisation unique et ne peuvent pas être réutilisés, remis à neuf ou revendus.
4. QIAGEN rejette notamment toutes les autres licences, expresses ou tacites, autres que celles énoncées expressément.
5. L'acheteur et l'utilisateur du panel s'engagent à ne pas prendre, ou autoriser quiconque à prendre, de quelconques mesures pouvant entraîner ou faciliter des actes interdits par les conditions précédentes. QIAGEN peut faire appliquer les interdictions de ce Contrat de licence limitée par tout tribunal et pourra recourir tous ses frais de recherche et de justice, y compris les frais d'avocats, en cas d'action en application de ce Contrat de licence limitée ou de tous ses droits de propriété intellectuelle liés au panel et/ou à ses composants.

Pour prendre connaissance des termes de licence mis à jour, consulter le site www.qiagen.com.

Marques de commerce : QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAsymphony®, QIAcube® (Groupe QIAGEN); Eppendorf®; ThermoMixer® (Eppendorf AG).

Jun-2022 HB-3029-001 1127540FRCA © 2022 QIAGEN, tous droits réservés.

Commandez sur www.qiagen.com/shop | Assistance technique support.qiagen.com |
Site Web www.qiagen.com